

Příručka k Hilandu 644 Přístroj k určení a měření elektronických součástek, a elektrických hodnot. Verze 1.13k ale také 1.37m

Karl-Heinz Kübbeler
kh_kuebbeler@web.de







&

Markus Reschke
madies@theca-tabellaria.de

Zkompilováno
od bm-magic

©

10. února 2020



15.05.2019/MOR

Obsah

1 Úvodem	4
1.1 Původ	4
1.1.1 UPOZORNĚNÍ!	4
1.2 Licence	4
1.2.1 Dostatečné licenční upozornění	4
1.3 Bezpečnost	4
2 Hardware	5
2.1 Popis	5
2.2 Ovládání	6
2.2.1 Tlačítko	6
2.2.2 Rotační kodér	6
3 Vlastnosti	7
3.1 Automatické zjištění součástek	7
3.1.1 Výběrové menu	8
3.2 Důležité poznámky pro použití	8
3.3 Problémové součástky	9
3.4 Dostupné jazyky	9
4 Funkce voleb u k-verze	10
4.0.1 Jednotlivé měření	10
4.0.2 Kontinuální měření	10
4.0.3 Opakované měření	10
4.1 Volitelné funkce menu	10
4.1.1 Frekvence	10
4.1.2 f-generátor	11
4.1.3 10-bit PWM	11
4.1.4 C+ESR@TP1:3	11
4.1.5 Měření odporů	11
4.1.6 Měření kondenzátorů	11
4.1.7 Pulzní Enkodér	11
4.1.8 C(μF)-korekce	12
4.1.9 Autotest	12
4.1.10 Napětí	12
4.1.11 Kontrast	12
4.1.12 Zobrazit údaje	12
4.1.13 Vypnout	12
4.1.14 Transistor	12
4.2 Autotest a kalibrace	13
5 Funkce voleb u m-verze	14
5.0.1 Hledání komponentů	14

5.0.2	Monitorování baterie	14
5.0.3	Vypínání,	14
5.1	Výběrové menu	14
5.1.1	Rozšířený PWM-Generátor	15
5.1.2	Obdélníkový signální generátor	15
5.1.3	Zjištění Zenerového napětí a voltmetr	15
5.1.4	měření ESR (ekvivalentní sériový odpor)	15
5.1.5	Unikající proud kondenzátoru	16
5.1.6	Rozšířený čítač frekvence	16
5.1.7	Počítadlo událostí (s hardwarovou úpravou)	16
5.1.8	Rotační kodér	16
5.1.9	Kontrast	16
5.1.10	Detektor/Dekodér pro IR dálkové ovládání	17
5.1.11	IR dálkové ovládání	18
5.1.12	Test optických spojek	19
5.1.13	Test servopohonů pro modely	19
5.1.14	Snímač teploty DS18B20	20
5.1.15	Autotest	20
5.1.16	Samočinné nastavení	20
5.1.17	Uschovat/Použít	21
5.1.18	Ukázat hodnoty	21
5.1.19	Vypnout	21
5.1.20	Konec	21
6	Programový kód	22
6.1	V k-verzi	22
6.2	V m-verzi	22
6.3	Makefile	22
6.3.1	MCU úprava	22
6.3.2	Avrdude ISP-Programátor	23
6.4	config.h	24
6.4.1	Pro tento tester musí být změněno	24
6.5	Config_644.h	26
6.5.1	Nutné změny	26
6.5.2	Poznámka	26
7	Programování testeru	27
7.1	Konfigurace testeru	27
7.2	Programování testeru	27
7.2.1	Operační system Linux	27
7.2.2	Použití s Linuxem	27
7.2.3	Instalace programových balíčků	28
7.2.4	Stáhnutí zdrojů	28
7.2.5	Používání rozhraní	28
7.2.6	Členství ve skupině	29
7.2.7	Příprava pracovního prostředí	29
7.2.8	U k-verze	30
7.3	Hardware k programování	30
7.3.1	Programátor	30
7.3.2	Možnost ke koupi:	30
7.4	Šema Hilandu s ATmega644	31
7.5	Technické údaje	32
7.6	Pomoc	32

Každý z nás zná tento problém: vymontuje transistor nebo ho najde mezi svými poklady, když je jeho označení čitelné a technické údaje nebo náhrada dostupné, je všechno v pořádku. Pokud ale ne, nastává otázka, co je to za součástku. S konvenčními měřicími metodami je těžké a zdouhavé typ součástky a její parametry zjistit. Může se jednat o NPN, PNP, N- nebo P-Kanal-MOSFET atd. Nápad Markuse F., je, aby tuto práci za nás udělal AVR-Mikrokontrolér.

Předcházející věty jsou opsány z návodu na Tranzistor Tester od Karl-Heinz Kübbelera. Ostatně, velký díl tohoto návodu pochází z výtažků díla tohoto autora,

...kterému bych rád tímto poděkoval...

1.1. Původ

Transistor Tester je založen na projektu Markuse Frejka [1] s pokračováním Karl-Heinze Kübbelerem [2] a Markuse Reschkeho [3]. Zatímco firmware Karl-Heinze je oficiální verze a podporuje starší typy MCU ATmega, slouží firmware od Markuse k vyzkoušení a testování nových nápadů a nabízí některé změny uživatelského rozhraní a postupy měření a testování. Kromě toho je omezena na ATmegas s minimálně 32kB Flash.

...také tomuto vývojáři bych tímto rád poděkoval...

Specifikace Obě verze jsou navrženy pro použití v různých testerech s odlišným hardwarem, a proto je třeba je nakonfigurovat. Oba vývojáři používají své vlastní metody. K usnadnění, byla vytvořena tato příručka.

1.1.1. UPOZORNĚNÍ! původní čínská softwarová verze má v MCU nastaveny bezpečnostní bity, proto není možné tento stav zálohovat.

Tím pádem ... bohužel ... nevede žádná cesta, zpět k původní verzi softwaru.

1.2. Licence

Autor původní verze má pouze dvě licenční podmínky.

Za prvé je projekt otevřený zdrojový kód,

a za druhé by měli komerční uživatelé kontaktovat autora.

- Bohužel, ani Karl-Heinz, ani Markus se dosud k autorovi nedostali.

K vyřešení problému s nedostačující "open source" licenci, vybral Markus 1.1.2016 standardní licenci pro otevřený zdroj, poté co měl původní autor dost času oznámit svá přání k licenci.

Vzhledem k tomu že tyto verze firmwaru jsou zcela nové verze, které zabírají jen několik nápadů původního firmwaru, ale nesdílí žádný kód, by to mělo být odůvodněno.

Licencováno v rámci EUPL V.1.1

1.2.1. Dostatečné licenční upozornění

Názvy produktů nebo společností mohou být registrované ochranné známky příslušných vlastníků.

1.3. Bezpečnost

Tester není multimetr!


Je to jednoduchý tester komponentů, který dokáže měřit různé věci.

Vstupy nejsou chráněny a budou poškozeny napětím nad 5V.

Nepoužívej tester pro obvody v provozu, ale pouze pro jednotlivé komponenty! U kondenzátorů se ujisti, že jsou vybité **před zapnutím** testera.

Používáš na vlastní nebezpečí!

2.1. Popis

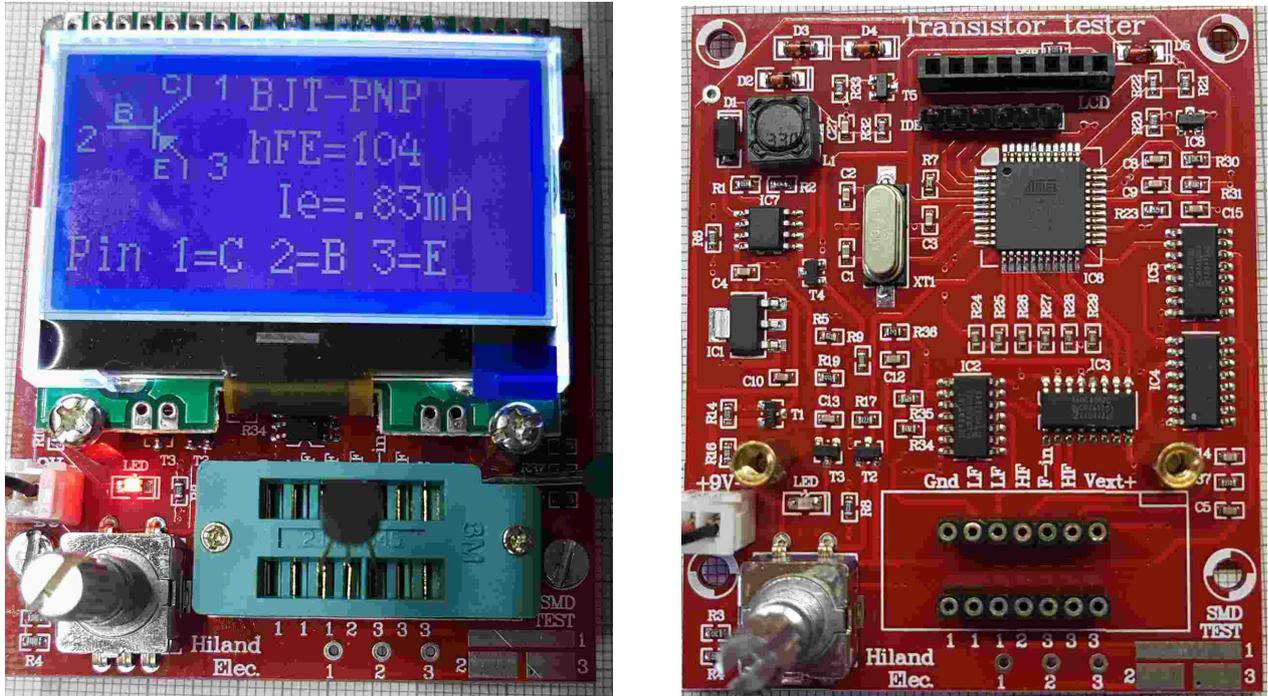

(a) dolní piny TP1 až TP3 pro určení součástek

(b) V horní řadě zásuvky jsou piny pro zvolená menu

Obrázek 2.1. Hiland Tester mit Testsocket und 128x64 Pixel Display

Testovací piny TP1, TP2 und TP3 se používají k automatickému určení součástek a jsou označeny čísly **1,1,1; 2; 3,3,3**. Stejné označení se nachází v SMD poli. Kromě toho lze naletovat vlastní kabely.

Testovací pin TP2 má kromě toho funkci výstupu v menu „f-Generator”.

Horní řada testovacího soklu je obsazena následovně:

S **LF** označené piny jsou určeny k měření krystalu s nízkou rezonanční frekvencí,

a **HF** označené piny, jsou pro měření krystalu s vysokou rezonanční frekvencí.

Pin **F-in** lze použít dohromady **Gnd** pro menu funkci měření frekvence.

a **Vext+** právě tak s **Gnd** k měření napětí a k určení Zenerových diod.

Pod displejem se nachází IDE rozhraní, které je takto obsazeno:

zleva doprava: 1 -Reset; 2 -SCK; 3 -MISO; 4 -MOSI; 5 -+5V; 6 -GND.

Tester používá ATmega 644PA a je obsazen s 8 MHz krystalem.

- K zobrazení je zde grafický LCD display ST7565 s 128 x 64 pixely, což v praxi znamená, čtyři lehce čitelné řádky, jak je vidět na obrázku, nebo dokonce i osm, také dobře čitelných řádků použitých ve standardní m-verzi.

- Energii dodává 9V E-blok baterie.

- Na desce je DC-DC-konvertor. To umožňuje určení Z-diod do 50 V.

- Frekvenční dělič 16:1 je také na palubě.

2.2. Ovládání

je realizováno rotačním kodérem s tlačítkem.

Obsluha testeru je jednoduchá. Nicméně zde je pár rad pro jeho použití.

K určení součástek je zodpovědná **dolní** řada zástrčky a SMD testovací pole.

Třípólové součástky můžeš vložit do tří, různě popsaných bodů, v libovolném pořadí.

U dvoupólových součástek můžeš použít kterékoliv dva rozdílné testovací porty.

Nezáleží ani na polaritě, to znamená že i etyly mohou být připojeny libovolně. Měření kapacity se však provádí tak, že záporný pól je na měřícím portu s nižším číslem.

Protože měřicí napětí leží mezi 0,3V a maximálně 1,3V, nehraje zde polarita důležitou roli.

Je-li součástka připojena, nesmíš se jí během měření dotýkat. Dej ji na izolační podklad, pokud není v zásuvce. Nedotýkej se se ani izolace měřicích kabelů, výsledek měření tím může být ovlivněn.

Poté stiskni tlačítko start. Po úvodním hlášení se zobrazí výsledek měření asi do dvou sekund. Při měření kondenzátorů může, v závislosti na kapacitě, trvat mnohem déle.

Co se stane poté, závisí na použité softwarové verzi a konfiguraci.

Aby bylo možné srovnání, byly v obou verzích zvoleny, pokud možno, stejné konfigurace a časy.

2.2.1. Tlačítko zapíná tester a slouží k **obsluze**. V automatickém režimu čeká tester v obou verzích 30 vteřin na součástku...poté vypne pro úsporu baterie.

Je-li v tom čase vložena součástka chovají se tyto verze **rozdílně**.

U m-verse vypne tester automaticky po 30 vteřinách. Dříve vypneš delším stiskem tlačítka.

- Nové měření docílíš krátkým stiskem, nebo otočením kodéru doprava.
- Menu dosáhneš dvojitým stiskem nebo točením kodéru doleva.

Tester rozlišuje mezi:

1. **krátkým stisknutím**, které se obvykle používá k pokračování funkce nebo k výběru další položky nabídky,
2. **dlouhým zmáčknutím** (> 0,3s), které provádí kontextovou akci a
3. **dvojitým stisknutím**, které akci ukončí.

Pokud tester očekává stisknutí klávesy pro pokračování v aktuální akci, je to označeno kurzorem v pravé dolní části modulu LCD.

Statický kurzor signalizuje, že následuje více informací a blikající kurzor znamená, že hledání součástek pokračuje.

U nabídek a některých dalších funkcí se kurzor nezobrazí, protože očekávaný vstup by měl zde být jasný.

U k-verse tester nevypne, ale čeká na další součástku, kterou měří po vložení automaticky.

K vypnutí je nutné zmáčknutí tlačítka nebo rychlé točení kodérem libovolným směrem.

- Menu dosáhneš po zapnutí **bez součástky** a to dlouhým stiskem (> 0.5s) nebo rychlým točením kodéru. Po vložení součástky zde menu nedosáhneš.

2.2.2. Rotační kodér dodává další funkce, závislé na kontextu.

Podrobnosti jsou vysvětleny v následujících částech.

Některé funkce umožňují větší změny díky rychlosti otáčení nebo skoky hodnot.

Detekce rychlosti otáčení měří dobu dvou kroků. Proto bys měl s kodérem udělat alespoň dva kroky pro střední rychlost. Pro vyšší rychlost to jsou tři kroky.

Jediný krok vede vždy k nejnižší rychlosti.

Detaily se dozvíš v dokumentaci, přímo od autorů patřičné verze. Viz [4].

3.1. Automatické zjištění součástek

1. Detekce NPN a PNP bipolárních tranzistorů, N- a P-KANÁLOVÝ MOSFET, JFETs, diody, dvojitě diody, N- a P-IGBT, tyristory a triaky. Pro tyristory a triaky musí být dosaženo dostatečné zapalovací a udržovací napětí a proudy. U IGBT musí být prahové napětí brány nižší než 5V.
2. Znázornění rozložení pinů testovacích součástek.
3. Měření stávajícího zesilovacího činitele a prahového napětí báse-emitor pro bipolární tranzistory.
4. Darlingtonovy tranzistory jsou charakteristické vyšším prahovým napětím a vysokým proudovým zesílením.
5. Automatická detekce ochranné diody v bipolárních tranzistorech a MOSFETů.
6. Měření prahového napětí, vstupní kapacity a R_{DSon} s hradlovým napětím těsně pod 5V u MOSFETů.
7. Jsou měřeny a zobrazeny až dva odpory jako  symboly a jejich hodnoty jsou až na čtyři desetinná místa ve správné hodnotě. Všechny symboly jsou zarámovány s testovacími čísly, jak byly nasazeny do zkoušečky (1-3). Proto lze také měřit potenciometry. Když ale potenciometr dosáhne koncové polohy, Není možné rozlišit mezi prostředním a koncovým kontaktem.
8. Odpory lze nyní měřit od $0,01\Omega$, do $50M\Omega$.
9. Kondenzátor je také detekován a změřen. Je označen symbolem  Jeho kapacita je určena a zobrazena až na čtyři desetinná místa přesně. Hodnota může být v rozmezí od $25pF$ (při $8MHz$ taktu, $50pF$ při $1MHz$ taktu) do $100mF$. Rozlišení je $1pF$ (u $8MHz$ taktu).
10. U kondenzátorů s kapacitou větší než $20nF$ je kromě toho měřen ještě ekvivalentní sériový odpor (ESR) kondenzátoru s rozlišením $0,01\Omega$ a zobrazen na dvě desetinná místa.
11. U kondenzátorů s kapacitní hodnotou nad $5000pF$ lze po nabíjecím impulsu určit ztrátovou hodnotu Vloss. Ztrátová hodnota v procentech indikuje kvalitu kondenzátoru.
12. Až dvě diody jsou označeny symbolem  nebo symbolem  a jsou zobrazeny ve správném pořadí. Kromě toho jsou zobrazeny úbytky napětí na diodách.
13. LED dioda je rozpoznána jako dioda, úbytek napětí je ale mnohem vyšší než u normální diody. Dvojitě diody jsou rozpoznány jako dvě diody.
14. Zenerovy diody lze detekovat, když je Zenerovo napětí pod hodnotou 4,5V. Zobrazují se jako dvě diody, rozpoznat je lze jen přes zobrazené napětí. Vnější čísla zkušebního kontaktu obklopující symboly diod jsou v tomto případě totožné. Skutečnou anodu diody lze nalézt pouze pro diodu, jejíž prahové napětí je blízké napětí $700mV$!
15. Pokud se zjistí více než 3 diody, zobrazí se spolu s chybovou zprávou počet nalezených diod. K tomu může dojít pouze v případě diod na všech třech zkušebních pinech a jsou spojeny a alespoň jedna z nich je Zenerova dioda. V tomto případě je třeba připojit pouze dva testovací kontakty a restartovat skenování a měřit jednu diodu za druhou.
16. Kapacita diody v závěrném směru je určena automaticky. Bipolární tranzistory lze také testovat, pokud je připojena pouze báse a buď kolektor nebo emitor. Pro ATmega s více než 8k flash paměti je kromě toho měřen ještě zpětný proud s rozlišením $2nA$. Hodnota je zobrazena pouze tehdy pokud je rozdílná od nuly.
17. Zapojení usměrňovacího můstku lze zjistit pouze jedním měřením.

18. Kondenzátory s hodnotami kapacity pod $25pF$ není možné běžně rozpoznat, ale mohou být použity společně s diodou zapojenou paralelně nebo s paralelně připojeným kondenzátorem kapacity nejméně $25pF$. V tomto případě musí být od výsledku měření odečtena hodnota kapacity součásti zapojené paralelně. U procesorů s minimální pamětí 32K flash se tester změni pomocí kondenzátoru $> 25pF$ mezi TP1 a TP3 v cyklické měření kondenzátoru, která také přímo měří kapacity od $1pF$.
19. Pro odpory pod 2100Ω se také provádí měření indukčnosti pokud má ATmega nejméně 16K flash paměti. Kromě symbolu odporu  se zobrazí symbol indukčnosti . Rozsah zobrazení je asi $0,01mH$ až přes $20H$, ale přesnost není vysoká. Výsledek se zobrazuje pouze pro jeden rezistor společně s hodnotou odporu.
20. Doba měření je asi dvě sekundy, měření kapacity a indukčnosti mohou trvat déle.
21. Software lze konfigurovat pro sérii měření s předem definovaným počtem opakování, než se automatické vypne.
22. Vestavěná funkce automatického testování včetně volitelného frekvenčního generátoru $50Hz$ pro přesnost kontroly frekvence a časové prodlevy.
23. Volitelná možnost kalibrace pro měření kondenzátoru a vnitřní odpor pro automatické určování portů během samočinného testu. Externí kondenzátor s kapacitou mezi $100nF$ a $20\mu F$ na testovacích kontaktech TP1 a TP3 je nutný, pro kompenzaci vyrovnávacího napětí analogového komparátoru. To může snížit chybu měření při měření kapacity až na hodnotu $40\mu F$. Stejným kondenzátorem je korekční napětí pro nastavení správného zesílení pro výpočet měření ADC pomocí vnitřního referenčního napětí $1,1V$.
24. Zobrazení kolektor - emitor zbytkového proudu I_{CE0} při odpojené bázi ($1\mu A$ přesnost) a zbytkový proud kolektor - emitor I_{CES} s bází připojenou na potenciál emitoru. Tyto hodnoty se zobrazují pouze v případě, že nejsou nulové (zejména pro germaniové tranzistory).
25. Pomocí funkce menu lze provést měření frekvence na portu PD4 ATmega. Rozlišení je $1Hz$ na vstupních frekvencích nad $33kHz$. Při nižších frekvencích může být rozlišovací schopnost až $0,001mHz$.
26. Pomocí funkce menu a při vypnutí UART módu lze měřit externí napětí do $50V$ přes 10:1 dělič napětí na PC3 kontaktu. V této větvi je možné, při současném podržení tlačítka, testovat Zenerovy diody.
27. Pomocí další funkce menu lze na kontaktu TP2 (PB2 port ATmega) zapnout výstup frekvence. V současné době lze frekvence nastavit od $1Hz$ do $2MHz$.
28. Pomocí další funkce menu lze zapnout na pinu TP2 (PB2 port ATmega) pevně danou frekvenci s nastavitelnou šířkou impulsu. Šířku impulsu lze zvýšit o 1% krátkým stiskem klávesy a o 10% s delším stiskem.
29. Pomocí další funkce menu lze spustit speciální měření kondenzátoru s měřením ESR. Tato funkce se při výběru nazývá C+ESR@TP1:TP3. Kapacity od přibližně $2\mu F$ až do $50mF$ mohou být měřeny pro nízké měřicí napětí okolo $300mV$ v zapájeném stavu.
30. Lze také použít ADC s metodou vzorkování, která umožní měřit kondenzátory pod $100pF$ s rozlišením $0,01pF$. Stejným způsobem je možné měřit také cívky pod $2mH$ čímž lze dosáhnout výrazně lepší rozlišení než rezonanční frekvence s paralelním kondenzátorem známé velikosti.

3.1.1. Výběrové menu nabízí další volitelné možnosti testeru. Tyto jsou rozlišné podle použité verze. Některé funkce se stejným nebo podobným názvem nabízí jiné možnosti a má také jiné ovládání. Důkladnější popis najdeš přímo u popisu verze. Viz [4].

3.2. Důležité poznámky pro použití

Nemůže být často připomínáno, že je třeba před měřením kondenzátory vybit. V opačném případě může být tester poškozený již před stiskem tlačítka Start.

Při měření zapájených součástí musí být zařízení vždy vypnuto. Kromě toho se ujistěte, že v měřeném přístroji nezůstalo žádné zbytkové napětí.

Všechna elektronická zařízení uvnitř obsahují kondenzátory!

Při měření malých odporů je třeba věnovat zvláštní pozornost odporu měřicích kabelů a přechodových odporů kontaktů.

Kvalita a stav konektorů hrají velkou roli, stejně jako odpor měřicích kabelů.

Totéž platí pro měření hodnoty ESR kondenzátorů.

Se špatnými měřicími kabely s krokosvorkami se může ESR odpor z $0,02\Omega$ dosáhnout lehce hodnoty $0,61\Omega$.

Pokud je to možné, připájejte měřicí kabely s krokosvorkami k testovacím portům paralelně s existujícími konektory. Pak nemusí být tester, při měření malých kapacit pokaždé kalibrován, pokud měříte pomocí zkušebních kabelů, nebo bez nich.

Při kalibraci nulového odporu je však rozdíl, pokud jsou testovací piny připojeny ke zkušebním svorkám přímo na základně nebo přes kabel.

Pouze ve druhém případě je odpor kabelu a svorek kalibrován.

Pokud máš pochybnosti, proveď kalibraci pomocí zkratu na zkušební zásuvce a poté změř odpor zkratovaných měřicích kabelů.

3.3. Problémové součástky

Ve výsledcích měření bys měl mít vždy na paměti, že byl tester navržen pro citlivé součástky.

Obvykle je maximální měřicí proud pouze $6mA$.

Výkonové polovodiče často způsobují problémy při zjišťování, nebo měření vysokých zbytkových proudů malým měřicím proudem.

Pro tyristory a triaky nejsou často dosaženy spínací, nebo přídržné proudy.

To je důvod, proč je občas tyristor detekován jako NPN tranzistor, nebo dioda.

Stejně tak se může stát, že některý tyristor, nebo triak nebude vůbec rozpoznán.

Další Problém vzniká s detekováním polovodičů obsahujících integrované odpory, takže dioda báze-emitor BU508D tranzistoru nebyla v důsledku paralelně zapojeného vnitřního 42Ω odporu detekována.

Z toho plyne, že zde funkce tranzistoru nemůže být testovaná.

Problémy s rozpoznáním jdou často také u výkonových tranzistorů Darlington.

Tady je také často vestavěný odpor mezi bází a emitorem, které komplikují detekci kvůli nízkým měřicím proudům, které se zde používají.

3.4. Dostupné jazyky

- angličtina
- k brazilčina
- čeština
- dánština
- k holandština
- italština
- k litevština
- k slovenština
- k slovinština
- španělština
- k maďarština
- němčina
- k polština
- ruština

Při spuštění testeru se zobrazí po dobu jedné vteřiny napětí baterie. Pokud napětí klesne pod hranici, bude za tímto textem vydáno varování.

Pokud používáš dobíjecí 9V-baterii, měl bys ji co nejdříve dobít a jednorázovou baterii vyměnit. V druhém řádku se ukáže naměřené provozní napětí „VCC=x.xxV”.

4.0.1. Jednotlivé měření Pokud je tester konfigurován pro jedno měření (POWER_OFF-volba), Pokud nespustíš nové měření, vypne se tester kvůli úspoře baterie automaticky za 28 sekund (konfigurovatelné). Po vypnutí lze samozřejmě spustit nové měření, buďto se stejnou součástí, nebo také s jinou. Pokud chybí vypínací elektronika, zůstane zobrazen poslední výsledek měření.

4.0.2. Kontinuální měření Zvláštním případem je konfigurace bez funkce automatického vypnutí. V tomto případě je nutno nastavit možnost POWER_OFF v makefile. Tato konfigurace se obvykle používá pokud nejsou osazeny tranzistory pro automatické vypnutí. Místo toho je zapotřebí externí vypínač pro zapnutí / vypnutí. Zde tester opakuje měření až do vypnutí.

4.0.3. Opakované měření V tomto případě se testovací přístroj nevypne přímo po měření, ale až po zvoleném počtu. Chceš-li to nastavit, je volbě POWER_OFF v makefile přiřazeno číslo opakování (například 5). Ve standardním případě se přístroj vypne po pěti měřeních bez rozpoznání komponentu. Pokud je detekována další měřená součástka, vypne se po dvojnásobku, tj. Deset měření. Jediné měření s nerozpoznanou komponentou vynuluje počet zjištěných kusů na nulu. Stejně tak jediné měření s detekovanou komponentou vynuluje počet nerozpoznaných komponent na nulu. To má za následek, že i bez stisku startovacího tlačítka lze měřit další a další kusy, pokud se součástky pravidelně obměňují. Změna součásti s prázdnými měřícími svorkami mezitím provede měření bez detekované součásti. V tomto provozním režimu je pro zobrazení času speciální funkce. Při krátkém stisku start tlačítka, jsou výsledky měření zobrazeny pouze 5 sekund. Pokud držíš tlačítko start, až do zobrazení první zprávy, je doba zobrazení 28 sekund, jako u jednotlivého měření. Další měření v době zobrazování, je umožněno následujícím stiskem Start tlačítka.

4.1. Volitelné funkce menu

Když je zapnuta funkce menu, začne tester po dlouhém stisku tlačítka (> 0.5s) volbu dalších funkcí. Volitelné funkce se zobrazují na řádku 3 čtyřřádkového displeje. Předchozí a následující funkce jsou zobrazeny v řádcích 2 a 4. Po delším čekání bez odezvy tlačítka se program vrátí k normální funkci testeru. Krátkým stiskem tlačítka můžeš přepnout na další volbu. Dlouhým stisknutím tlačítka se spustí zobrazená doplňková funkce. Po zobrazení poslední funkce "Vypnout" se znovu zobrazí první funkce.

Výběr nabídky lze také docílit rychlým otáčením enkodéru.

Funkcemi nabídky lze listovat pomalým otáčením voliče v libovolném směru. Zvolenou funkci nabídky, lze spustit pouze stiskem tlačítka. V rámci vybraných nastavení funkce jsou další parametry volitelné pomocí pomalého otáčení enkodéru.

Rychlým otočením enkodéru se vrátíš do nabídkového menu.

4.1.1. Frekvence (frekvenční měření) používá jako vstupní pin PD4 ATmega, který je také připojen k LCD. Nejdříve je vždy měřena frekvence, při frekvencích pod 25kHz je také měřena střední hodnota vstupního signálu a z toho je vypočtena frekvence frekvence s rozlišením až 0,001Hz. Pokud je v souboru Makefile nastavena v makefile volba POWER_OFF je doba měření frekvence omezena na 8 minut. Měření frekvence je ukončeno stisknutím tlačítka a návratem do nabídky menu.

4.1.2. f-generátor (Generátorem frekvence) lze zvolit frekvenci mezi 1Hz a 2MHz. Nastavení frekvence lze měnit pouze v nejvyšším řádu. Pro frekvenci 1Hz až 10kHz jsou volitelná čísla 0-9. Od 100kHz je možné volit 0-20. V prvním řádku oznámí symbol > nebo < anžeigt, zde je možné delším tiskem (> 0.8s) přepnout na vyšší nebo nižší místo. Na nižší místo (<) lze přepnout pouze tehdy, je-li aktuální číslice nastavena na hodnotu 0 a pokud nebyl zvolen kroky nižší než 1Hz. V řádu 100kHz je symbol > nahrazen znakem R (reset). Delší tisk způsobí návrat frekvence na počáteční hodnotu 1Hz. Je-li v Makefile nastavená volba POWER_OFF- musí být stisk tlačítka pro změnu frekvence delší. Krátké stisknutí tlačítka (< 0,2s) pouze resetuje sledování času 4 minut. Uplynulý čas je zobrazen v 1 řádku tečkou za každých 30 sekund. Pravidelným krátkým stiskem tlačítka lze zabránit předčasnému vypnutí generování kmitočtu. Dlouhé stisknutí tlačítka (> 2s) způsobí návrat do menu.

4.1.3. 10-bit PWM (šířková modulace impulsů) generuje pevnou frekvenci s nastavitelnou šířkou impulsu na pinu TP2. Při krátkém stisknutí klávesy (< 0,5s) se šířka impulsu zvýší o 1%, s delším stisknutím klávesy o 10%.

Při překročení 99% bude 100% odečteno (zpátky na 0). Při zvolené možnosti POWER_OFF- v makefile, bude po 8 minutách bez stisku tlačítka, tester vypnutý. Konec generování je také možné dosáhnout dlouhým (> 1,3s) stiskem.

4.1.4. C+ESR@TP1:3 spustí samostatné měření kondenzátoru s měřením ESR. Měřitelné jsou kondenzátory s více než $2\mu F$ až k $50mF$.

Vzhledem k nízkému měřicímu napětí asi 300mV by mělo být ve většině případech možné měření v obvodu bez předchozího vypájení.

Pokud je v souboru Makefile nastavena možnost POWER_OFF-, je počet měření omezen na 250, může být ale znovu spuštěn.

Opakované měření může být ukončeno delším stiskem tlačítka.

4.1.5. Měření odporů Ikona 1——3 promění tester na ohmmetr mezi TP1 a TP3. Tento režim je indikován zobrazením textu [R] v pravém rohu prvního řádku displeje.

Protože se při této měřicí funkci nepoužívá ESR, platí pro odpory s hodnotou nižší než 10Ω rozlišení pouze 0.1Ω .

Pokud je funkce ohmmetru nakonfigurovaná i s měřením indukci, zobrazí se zde ikona 1———3. Funkce ohmmetru poté zahrnuje měření indukčnosti pro odpory pod 2100Ω . V pravém rohu prvního řádku displeje se zobrazí text [RL].

Pokud nebyla detekována žádná indukčnost pro odpory pod 10Ω tak je použita ESR metoda měření. To zvyšuje rozlišení rezistorů s hodnotou nižší než 10Ω na 0.01Ω .

V tomto měřicím režimu se měření opakuje bez stisku tlačítka. Stisknutím tlačítka opustíš tento režim a tester se vrátí do nabídky menu.

Pokud je mezi TP1 a TP3 připojený odpor je tento měřicí režim také automaticky spuštěn stiskem tlačítka. Po stisku tlačítka se tester vrátí ke své normální funkci.

4.1.6. Měření kondenzátorů Ikona 1——3 mění tester na klasický měřič kondenzátorů na TP1 a TP3. Tento režim je označen znakem [C] v pravém rohu prvního řádku displeje. V tomto režimu mohou být kondenzátory měřeny od $1pF$ do $100mF$.

V tomto provozním režimu se měření opakuje bez stisku tlačítka.

Stiskem tlačítka se tato speciální operace ukončí a tester se vrátí do nabídky menu.

Stejně tak jako u měření odporů se tento provozní režim automaticky zapne, pokud byl mezi TP1 a TP3 detekován kondenzátor.

Po stisku tlačítka se tester vrátí ke své normální funkci.

4.1.7. Pulzní Enkodér umožní tyto součástky testovat. Tři kontakty pulzního enkodéru libovolně připojíme ke třem zkušebním pinům před startem této doplňkové funkce.

Po spuštění funkce nesmí být otočným knoflíkem otáčeno příliš rychle. Po úspěšném dokončení testu je na druhém řádku zobrazen symbol přiřazení kontaktů.

Tester indikuje společný kontakt obou přepínačů a indikuje zda jsou v aretované poloze oba kontakty otevřené, ("o") nebo zavřené ("C").

Impulzní snímač s otevřenými kontakty v aretované pozici se zobrazí na řádce 2 „ 1 - / - 2 - / - 3 o "po dobu dvou sekund. Samozřejmě je správné číslo pinu společného kontaktu zobrazeno uprostřed namísto "2".

Dokonce i když je uzavřená poloha spínače v aretovaných pozicích, je také zobrazen na řádce 2, "1 — 2 — 3 C" po dobu dvou sekund. Neznám žádný pulsní snímač, který má vždy pouze uzavřené kontakty v každé pozici zámku. Polohy kontaktů mezi aretačními polohami se jen krátce ($< 0,5s$) zobrazí bez kódových písmen "o" nebo "C" v 2 řádce.

Pokud má být impulsní kódér použit k ovládání testeru, musí být v makefile volba `WITH_ROTARY_SWITCH=2` pro kódéry s pouze otevřenými kontakty ('o') a volba `WITH_ROTARY_SWITCH=1` pro snímače s otevřenými ("o") a uzavřenými ("C") kontakty v aretačních pozicích.

4.1.8. C (μF)-korekce umožní měnit korekční hodnotu pro měření kapacit velkých hodnot.

Stejnou korekci můžete také nastavit pomocí volby Makefile `C_H_KORR`. Hodnoty nad nulou snižují výstupní hodnotu kapacity o tuto procentuální hodnotu.

Hodnoty pod nulou výstupní hodnotu zvyšují.

Krátké stisknutí tlačítka snižuje korekční hodnotu o 0.1%, delší stisk tlačítka zvýší opravnou hodnotu o 0.1%.

Velmi dlouhým stiskem tlačítka se hodnota uloží.

Vlastností této metody měření je, že u nekvalitních elektrolytických kondenzátorů je naměřena kapacita výrazně vyšší než skutečná.

Kvalitu lze rozpoznat parametrem `Vloss`. Kvalitní kondenzátory nemají žádný `Vloss`, nebo pouze 0,1%. Pro nastavení tohoto parametru je třeba použít pouze kondenzátory s vyšší hodnotou než $50\mu F$ s vysokou kvalitou.

Mimochodem, považuji za zbytečné, určit přesnou hodnotu kapacity elektrolytických kondenzátorů, protože kapacita závisí jak na teplotě, tak na výši stejnosměrného napětí.

4.1.9. Autotest provádí kompletní autotest s kalibrací.

Všechny testovací funkce T1 až T7 (pokud tomu nebrání možnost `NO_TEST_T1_T7`) Pokaždé se provádí kalibrace s externím kondenzátorem.

4.1.10. Napětí (měření napětí) umožňuje měřit pozitivní DC napětí do 50 V. Kromě toho je zde možné pomocí stiskem tlačítka připnout DC-DC měnič, pro měření Z-diod. Je-li v makefile volba `POWER_OFF-Option` nastavena a není-li stisknuto tlačítko, skončí měření po 4 minutách.

Měření lze předtím ukončit dlouhým stiskem tlačítka (> 4 vteřiny).

4.1.11. Kontrast je k dispozici řadičům se softwarovým řízením kontrastu. Nastavenou hodnotu lze snížit velmi krátkým stisknutím tlačítka nebo levým otočením impulzního snímače. Dlouhým stiskem tlačítka, nebo otáčením pulzního enkodéru ve směru hodinových ručiček se hodnota kontrastu zvýší.

Pokud je tlačítko stisknuto déle, je funkce ukončena a nastavená hodnota je trvale zapsána do paměti EEPROM.

4.1.12. Zobrazit údaje zobrazuje, kromě údajů o verzi softwaru také údaje o kalibraci. Jedná se o přechodové odpory R0 kombinace pinů 1:3, 2:3 a 1:2. Také je změřen výstupní odpor měřících pinů proti 5V-(RiHi) a také proti 0V (RiLo). Také jsou zobrazeny hodnoty parazitní kapacity (C0) ve všech Pinových kombinacích (1:3, 2:3, 1:2 a 3:1, 3:2 2:1). Poté se také zobrazují korekce napětí komparátoru (`REF_C`) a pro referenční napětí (`REF_R`). U grafických displejů se zobrazí symboly použité pro součástky a font písma. Každá stránka se zobrazí 15 sekund. Na další stránku se také dostaneš stiskem tlačítka nebo otáčením enkodéru impulzů ve směru hodinových ručiček. Při otočení vlevo impulzního kódéru se zobrazení bude opakovat nebo přejde zpět na předchozí stránku.

4.1.13. Vypnout je touto funkcí možné.

4.1.14. Transistor vrátí zpět na normální funkci testeru tranzistorů.

Když je nastavena volba Makefile `POWER_OFF` jsou všechny přídatné funkce z důvodu úspory baterie časově omezené.

4.2. Autotest a kalibrace

Je-li v software konfigurovaná funkce Autotestu a kalibrace, může se provést samočinný test zkratováním všech tří testovacích portů a stiskem tlačítka Start.

Pro zahájení autotestu musí být během 2 sekund znovu stisknuto tlačítko start, jinak začne tester s normálním měřením.

Je-li tester konfigurován s funkcí menu (volba WITH_MENU), provádí se úplný samočinný test automaticky jen při prvním použití a dále pak pouze během "autotestu", který lze vybrat jako funkci menu.

Pro kalibraci jsou zkoušeny T1 až T7. Navíc se při volání funkce přes menu provádí nastavení s externím kondenzátorem.

Normálně se provádí pouze při první kalibraci, tímto způsobem lze autotest se zkratovanými vstupy provádět rychleji.

Čtyřnásobnému opakování testu na T1 až T7 je možné se vyhnout, pokud je trvale stisknuté tlačítko start. Takže můžeš rychle ukončit nezajímavé testy a interaktivní testy můžeš opakovat čtyřikrát uvolněním tlačítka start.

Čtvrtý test pokračuje automaticky pouze, pokud je uvolněný zkrat mezi testovacími porty. Je-li v Makefile vybrána funkce AUTO_CAL provede autotest kalibraci nulové hodnoty pro měření kondenzátorů. Pro tuto kalibraci je důležité, aby během čtvrté zkoušky bylo zrušen zkrat mezi testovacími piny.

Během kalibrace (po zkoušce 6) by ses neměl dotýkat testovacích portů, nebo připojených kabelů. Měřicí kabely, by měly být stejné, které budou poté použity k měření. V opačném případě nebude vynulování správně provedeno.

Při této volbě je kalibrace vnitřního odporu měřících portů provedena před každým měřením. Je-li v makefile nastavena funkce vzorkování volbou (WITH_SamplingADC = 1) jsou během kalibrace provedeny navíc dva speciální kroky. Po normálním měření nulových hodnot kapacity budou změřeny také nulové hodnoty metodou odběru vzorků (C0samp).

Poslední částí kalibrace je připojení zkušební kondenzátoru pro měření cívky mezi pinem 1 a 3 což je oznámeno požadavkem na vložení kapacity $1 \text{---} \text{||} \text{---} 3$ 10-30nF(L). Hodnota kapacity by měla být mezi 10nF a 30nF, k dosažení měřitelné rezonanční frekvence v pozdějším paralelním spojení s cívkou ($< 2mH$). U cívky s indukčností větší než 2mH by měla být použita běžná zkušební funkce bez připojeného paralelního kondenzátoru.

Paralelně připojený kondenzátor zde nezlepšuje výsledky měření.

Po měření nulové kapacity je nezbytné připojit kondenzátor s kapacitou mezi 100nF a 20μF mezi Pin 1 a Pin 3.

Z tohoto důvodu se v prvním řádku zobrazí požadavek na vložení kondenzátoru $1 \text{---} \text{||} \text{---} 3 > 100nF$. Kondenzátor bys měl připojit pouze po výstupu hodnot C0 nebo po zobrazení této hlášky.

S tímto kondenzátorem je proveden offset analogového komparátoru, k určení přesnějších hodnot při měření kapacit.

Navíc je tímto kondenzátorem také nastaven zisk ADC s vnitřním referencí k získání lepších výsledků při měření odporů s možností AUTOSCALE_ADC.

Pokud byla na testeru vybrána funkce menu (volba WITH_MENU) a autotest nebyl spuštěn ve funkci menu, nastavení provede se kalibrace s externím kondenzátorem pouze při prvním zapnutí přístroje.

Kalibrace s externím kondenzátorem se opakuje pouze v případě, že se provádí autotest funkcí menu.

Offset pro měření ESR je přednastaven jako volba Option ESR_ZERO v makefile.

Při každém autotestu je nulová hodnota ESR znovu určena pro všechny tři kombinace měřících pinů.

Metoda ESR měření se používá také pro odpory s hodnotami pod 10Ω, zde slouží k dosažení rozlišení 0,01Ω.

Dlouhým stisknutím při zapnutí se aktivuje režim automatického přidržování. V tomto režimu čeká tester na krátké stisknutí tlačítka k pokračování testování.

Jinak běží tester v nepřetržitém režimu. Výběr můžeš s (UI_AUTOHOLD) v config.h obrátit.

Po zapnutí se krátce zobrazí verze firmwaru.

S velmi dlouhým stiskem tlačítka (2s) při zapnutí, se vrátí tester na uložené standardní hodnoty. - To může být výhodné, když je např. kontrast LCD modulu tak nastaven, že nic nevidíš.

Pokud tester zjistí problém s uloženými hodnotami nastavení (problém s EEPROM), zobrazuje chybu kontrolního součtu a místo toho používá také výchozí hodnoty.

5.0.1. Hledání komponentů Po zapnutí tester automaticky vyhledá komponenty.

V nepřetržitém režimu tester opakuje hledání po krátké čekací době.

Pokud není, několikrát za sebou, nalezeno žádné zařízení, tester se sám vypne.

V Auto Hold režimu (signalizováno kurzorem) provede tester jednu operaci a čeká, před zahájením dalšího vyhledávání, na stisknutí tlačítka nebo otočení rotačního kodéru doprava.

Čekací přestávka a automatické vypnutí v nepřetržitém režimu mohou být změněny prostřednictvím CYCLE_DELAY a CYCLE_MAX (strana 24) v config.h.

Režim automatického přidržování POWER_OFF_TIMEOUT (strana 25) má volitelné automatické vypnutí, které je aktivní pouze při vyhledávání komponent a výstupu.

V obou režimech můžete vyvolat hlavní nabídku (viz níže).

5.0.2. Monitorování baterie je možné nastavit podle tvých představ na stránce ???. Každý cyklus hledání součástí začíná zobrazením napětí baterie a jejího stavu (ok, slabý, prázdný). Při poklesu pod její prahové napětí tester vypne. Baterie je kontrolována i během provozu.

Výchozí konfigurace monitorování baterie je navržena pro 9V baterii, ale lze ji přizpůsobit v sekci „power management“ v config.h na jakékoli jiné napájení.

Monitorování baterií může být deaktivováno pomocí BAT_NONE, přímé měření baterie menšího napětí než 5V, lze konfigurovat pomocí BAT_DIRECT, nebo nepřímé měření pomocí děliče napětí (definovaného BAT_R1 a BAT_R2).

Ačkoli některé testery podporují volitelné externí napájení, neumožňují jeho sledování.

V tomto případě můžeš podle BAT_EXT_UNMONITORED problémy s automatikou, při nízkém stavu napětí, vypnout.

Při externím napájení je stav baterie nastaven na „ext“ (externí).

Mezní hodnoty pro slabou a prázdnou baterii se nastavují pomocí BAT_WEAK a BAT_LOW, zatímco BAT_OFFSET definuje ztrátu napětí v okruhu, např. ochranná dioda s obrácenou polaritou a PNP tranzistor pro přepínání napájení.

5.0.3. Vypínání, když při zobrazení výsledku posledního hledání součásti, stiskneš dlouze tlačítko, ukáže tester krátce „sbohem“ nebo „Ciao!“ a vypne se. Po dobu stisknutí zůstane však stále zapnutý. To je příčinou konstrukce obvodové části napájecího zdroje.

5.1. Výběrové menu

docílíš krátkým dvojitým stisknutím testovacího tlačítka po výstupu posledního výsledku. (Možná budeš muset na začátku trochu cvičit, ;-)

nebo otočením rotačním kódérem vlevo.

S aktivováním UI_SHORT_CIRCUIT_MENU, lze také aktivovat starou metodu (zkratování tří zkušebních pinů).

V nabídce vybereš další položku krátkým stisknutím. Dlouhým stisknutím ji zvolíš.

Vybraný bod je označen „*“.

Otáčením kodéru dosáhneš předchozí nebo následující bod. I zde dochází k přetečení, tzn. od posledního k prvnímu bod.

Na rozdíl od předešle, zde vybírá položku **krátký stisk** tlačítka.

Některé body/doplňky ukazují krátce na začátku rozložení použitých testovacích pinů.

Informace se zobrazí na několik sekund, ale můžeš ji krátkým stiskem tlačítka přeskočit.

Funkce, které generují signály, vysílají jejich signál standardně na pinu # 2.

Přitom budou piny # 1 a # 3 uzemněny.

5.1.1. Rozšířený PWM-Generátor dělá přesně to, co čekáš :-)

Rozložení testovacích pinů:

Pin # 2: výstup (přes 680Ω odpor k omezení proudu)

Pin # 1 a # 3: uzemněny

Krátkým stiskem klávesy se zde přepíná mezi frekvenčním a pracovním cyklem. Vybraná hodnota je označena hvězdičkou.

Točením rotačního kodéru vpravo zvolenou hodnotu zvyšuješ, doleva jí snižuješ.

Dlouhý stisk tlačítka zde obnoví výchozí hodnoty (frekvence: 1 kHz, pracovní cyklus: 50 %).

Dvojitým stisknutím tlačítka PWM generátor ukončíš.

5.1.2. Obdélníkový signální generátor vydává signál s čtvercovou vlnou s proměnnou frekvencí až do 1/4 MCU taktu (2MHz při 8MHz taktu). Počáteční frekvence je 1 kHz a pomocí otočného kodéru se nechá měnit. Stupeň změny určuje rotační rychlost, tzn. pomalé otáčení způsobí malé změny a rychlé otáčení velké.

Protože je generování signálu založeno na interní PWM funkci MCU, není možné generovat libovolné frekvence, ale pouze v krocích. Pro nízké frekvence je velikost kroku je poměrně malá, pouze při vysokých frekvencích se stává významnou.

Dlouhé stisknutí tlačítka vrátí frekvenci na 1 kHz a dvojitě stisknutí ukončí generátor.

Rozložení testovacích pinů:

Pin # 2: výstup (přes 680Ω odpor k omezení proudu)

Pin # 1 a # 3: uzemněny

Poznámka: Nutný Rotační enkodér nebo jiná volba ovládání!

5.1.3. Zjištění Zenerového napětí a voltmetr s pomocí DC-DC převodníku je možné generovat testovací napětí do 50V k testování Zenerových diod. Připojení se provádí pomocí svých vlastních testovacích pinů.

Dokud je testovací tlačítko stisknuto, generuje měnič testovací napětí a zobrazí proudové napětí.

Po uvolnění tlačítka se zobrazí nejmenší naměřené napětí, pokud běžel test dostatečně dlouho pro stabilní zkušební napětí.

Tento proces lze libovolně často opakovat. K ukončení použij jako obvykle dvojitě stisknutí.

Obvod pro Zenerovou diodu:

Pin +: katoda

Pin -: anoda

5.1.4. měření ESR (ekvivalentní sériový odpor) může měřit a zobrazovat kondenzátor v obvodu a kromě kapacity měří také ESR pokud v obvodu kondenzátor najde.

Před připojením se přesvědč, že je kondenzátor vybitý!

Měřené hodnoty mohou mít odchylky způsobené paralelními komponenty v obvodu.

Pro zahájení měření krátce stiskni testovací tlačítko.

Chceš-li program ukončit, stiskni dvakrát za sebou zkušební tlačítko.

Obvod pro měření ESR:

Pin #1: +

Pin #3: -

5.1.5. Unikající proud kondenzátoru Test svodového proudu nabíjí kondenzátor a zobrazuje proud a napětí na měřicím odporu. Načítání začíná s Rl (680Ω) a přepne na Rh (470kΩ), jakmile dosáhne tok určitého limitu. Každý zkušební cyklus začíná zobrazením přiřazení zkušebních pinů. Po připojení kondenzátoru začíná ládování stisknutím testovacího tlačítka (nebo točením rotačního kodéru doprava).

Další stisknutí ukončí nabíjení a tester vybijí kondenzátor a zobrazuje zbytkové napětí.

Po dosažení limitu vybití začne tester nový testovací cyklus.

Chceš-li test ukončit, stiskni dvakrát krátce testovací tlačítko.

Poznámka: **Věnuj pozornost polaritě Elkos!**

Zapojení kondenzátoru:

Pin #1:	+
Pin #3:	-

5.1.6. Rozšířený čítač frekvence má další předzesilovač, který povoluje měření vyšších frekvencí.

Teoretické maximum je 1/4 taktu MCU vynásobených prescalerem (16:1 nebo 32:1). Ovládací signály jsou definovány v config<mcu>.h, a prosím nezapomeň v config.h na výběr správného předzesilovače. Vstup signálu (vyrovnávací vstup, křemenný oscilátor pro nízké hodnoty) nebo (frekvence, křemenný oscilátor pro vysoké frekvence) změníš pomocí testovacího tlačítka nebo rotačního kodéru. Počítadlo kmitočtů zastaví dva krátké stisky tlačítka.

5.1.7. Počítadlo událostí (s hardwarovou úpravou) Čítač událostí používá pin T0 (F-in) jako pevný vstup a reaguje na náběžnou hranu signálu. Pin T0 není možné použít současně pro display. Doporučuje se jednoduchá úprava vstupu.

Čítač je řízen pomocí malého menu, které také hodnoty čítače zobrazí. Položky menu a jejich změna jsou vybírány krátkým stiskem, pomocí otočného kodéru nebo dalších tlačítek.

První položka nabídky je režim počítadla:

- Počítání počítá čas a události
- Čas počítá události za daný čas
- Události počítají čas pro daný počet událostí

Druhá položka nabídky „n“ je počet událostí. V režimu počítadla „Události“ zobrazí hodnotu zastavení, kterou lze změnit. Dlouhým stisknutím nastavíš hodnotu stop na výchozí hodnotu (100). V jiných režimech počítadla je tato položka nabídky blokována.

Další nabídka je „t“ časový interval v sekundách (výchozí: 60 s). Stejná hra, pouze pro režim času.

Poslední položka nabídky spustí nebo zastaví čítač dlouhým stisknutím tlačítka. V době provozu je počet událostí a uplynulý čas každou vteřinu aktualizován a poté co skončí měření.

Časový limit je 43200s (12h) a pro události $4 \cdot 10^9$. Jakmile je jedna z mezních hodnot překročena, počítadlo se automaticky zastaví. Limit nebo hodnota zastavení událostí se kontroluje každých 200 ms. Proto pokud hodnota překročí 5 událostí/s, lze tuto hodnotu překročit.

5.1.8. Rotační kodér testuje rotační enkodéry a určuje rozložení pinů. Tvým úkolem je připojit testovací piny k rotačnímu kodéru (A, B, Common) a točit enkodérem doprava (ve směru hodinových ručiček). Algoritmus vyžaduje pro detekci 4 kroky Grey kódu.

Směr otáčení je pro detekci A a B nutný, protože nesprávný směr by způsobil kroucení pinů. Když je rotační kodér detekován, vydá tester rozložení pinů a čeká (v automatickém režimu) na stisknutí tlačítka nebo (v nepřetržitém režimu) čeká chvíli.

Pro ukončení stiskni během vyhledávání krátce tlačítko testu.

5.1.9. Kontrast umožňuje upravení kontrastu.

Krátké stisknutí hodnotu zvýší, dlouhý stisk ji sníží. Také lze změnit hodnotu kontrastu točením kodéru. K ukončení, stiskni dvakrát za sebou zkušební tlačítko.

5.1.10. Detektor/Dekodér pro IR dálkové ovládání detekuje a dekoduje signály z IR ovladačů a vyžaduje IR přijímací modul, např. ze série TSOP.

Při překladu firmwaru si můžeš vybrat mezi dvěma variantami připojení.

V první variantě je modul připojen k normálním testovacím pinům.

Druhou variantou je pevný modul, který je připojen ke konkrétnímu MCU pinu.

Pokud je známý protokol zjištěn, poskytnete tester protokol, adresu (pokud je k dispozici), příkaz a případně hexadecimálně další informace.

Výstupní formát je: <Protokol> <Datová pole>

Pokud je datový paket vadný, ohlásí „?“.

Pokud je protokol neznámý, zobrazí tester počet pauz & pulsů a trvání prvního pulzu a první pauzy v jednotkách 50μs: ? <Pulse>: <první impuls> - <první pauza>

Pokud je počet pulzů na různých tlačítkách dálkového ovladače stejný, jedná se s největší pravděpodobností o PDM nebo PWM modulaci.

Měnící se počet pulzů naznačuje bi-fázovou modulaci.

K zastavení stiskni jednou testovací tlačítko.

Podporované protokoly a jejich datová pole:

- JVC <Adresa>: <příkaz>
- Kaseikyo (japonský kód, 48 bitů) <Code Vendor>: <System> - <Produkt>: <funkce>
- Matsushita (Panasonic MN6014, C6D6 / 12 bitů) <Code Zařízení>: <Data code>
- Motorola <příkaz>
- NEC (standardní a pokročilé) <Adresa>: <příkaz> R pro opakování sekvence
- Proton / Mitsubishi (M50560) <Adresa>: <příkaz>
- RC-5 (standardní) <Adresa>: <příkaz>
- RC-6 (standardní) <Adresa>: <příkaz>
- Samsung / Toshiba (32 bitů) <Code Zařízení>: <Data code>
- Sharp <Adresa>: <příkaz>
- Sony SIRC (12, 15 a 20 bitů) 12 & 15: <příkaz>: <adresa>
20: <příkaz>: <adresa>: <rozšíření>

Volitelné protokoly (SW_IR_RX_EXTRA):

- IR60 (SDA2008 / MC14497) <příkaz>
- Matsushita (Panasonic MN6014, C5D6 / 11 bitů) <Code Zařízení>: <Data code>
- NEC μPD1986C <Code dat>
- RECS80 (standardní a pokročilé) <Adresa>: <příkaz>
- RCA <Adresa>: <příkaz>
- Sanyo (LC7461) <Code Zařízení>: <key>
- Thomson <Zařízení>: <funkce>

Nosná frekvence přijímacího modulu TSOP IR nemusí přesně odpovídat dálkovému ovládání.

Ve skutečnosti pouze snižuje rozsah, což pro náš účel ale nepředstavuje problém.

- IR přijímací modul na testovacích pinech

Nejprve připojte IR přijímací modul k IR detektoru dálkového ovládání!

Administrace pro modul TSOP:

Ukázka # 1: uzemnění / Gnd

Sonda # 2: Vs (680Ω omezovač proudu)

Sonda # 3: Data/Out

Poznámka: Odpor pro omezení proudu nastavuje IR přijímací modul s a předpokládá rozsah napájecího napětí asi 2,5 - 5V.

Pokud máš 5V modul, můžeš na vlastní nebezpečí odpor v config.h deaktivovat. Zkrat však může MCU zničit.

- Pevný IR přijímací modul

U pevného modulu nastav port a data v config<MCU>.h.

5.1.11. IR dálkové ovládání odešle kódy dálkového ovládání, které jsi dříve zadal a používá se k testování IR přijímačů nebo zařízení s IR dálkovým ovládáním.

Tato funkce vyžaduje další možnost vstupu, například např. rotační kodér, displej s více než čtyřmi řádky textu a jednoduchý obvod ovladače pro IR-LED.

Tester vám ukáže protokol, nosnou frekvenci, pracovní cyklus dopravce a několik datových polí.

Krátkým stisknutím testovacího tlačítka přepínáš tam a zpět mezi body.

Vybraný bod je označen znakem „*“.

Pomocí otočného enkodéru (nebo jiné možnosti vstupu) měníš nastavení nebo hodnotu bodu.

Tester odesílá IR kód tak dlouho, jak je testovací tlačítko stisknuto. A jako obvykle, dvě krátké stisknutí tlačítka funkci zastaví.

Pokud změníš protokol, nastaví se nosná frekvence a pracovní cyklus na výchozí hodnoty příslušného protokolu.

Tyto můžeš ale libovolně změnit.

Nosnou frekvenci lze nastavit na 30 až 56 kHz a pracovní cyklus zapnout na 1/2 (50%), 1/3 (33%) nebo 1/4 (25%).

Datová pole jsou části kódu dálkového ovládání, které můžeš nastavit.

Jsou níže vysvětleny a většinou jde pouze o adresu a příkaz.

Podporované protokoly a jejich datová pole:

- JVC <Adresa: 8> <příkaz: 8>
- Kaseikyo (japonský kód) <Výrobce: 16> <Systém: 4> <Produkt: 8> <Funkce: 8>
- Matsushita (Panasonic, MN6014 12 bitů) <Zařízení: 6> <tlačítko: 6>
- Motorola <Command: 9>
- Norma NEC <Adresa: 8> <příkaz: 8>
- NEC Extended <Adresa: 16)> <příkaz: 8>
- Proton / Mitsubishi (M50560) <Adresa: 8> <příkaz: 8>
- RC-5 standard <Adresa: 5> <příkaz: 6>
- RC-6 standard, režim 0 <Adresa: 8> <příkaz: 8>
- Samsung / Toshiba (32 bitů) <Zařízení: 8> <tlačítko: 8>
- Sharp / Denon <Adresa: 5> <příkaz: 8> <maskování: 1>
- Sony SIRC-12 <Příkaz: 7> <Adresa: 5>
- Sony SIRC-15 <Příkaz: 7> <Adresa: 8>
- Sony SIRC-20 <Příkaz: 7> <Adresa: 5> <Pokročilé: 8>

Volitelné protokoly (SW_IR_RX_EXTRA):

- Thomson <Zařízení: 4> <funkce: 7>

Datová pole jsou oddělena mezerami a jejich syntaxe je: <Název pole>: <počet bitů>


Rozložení testovacích pinů:

Pin # 2: výstup (přes 680Ω odpor k omezení proudu)

Pin # 1 a # 3: uzemněny

Signální výstup (testovací pin # 2) má odpor pro omezení proudu a může proto spínat pouze asi 5 mA, což pro typickou IR LED s I_f 100mA nestačí.

Obrázek 5.1 ukazuje ovladač, který lze pro IR-LED (V_f 1,5V, I_f 100mA) použít.

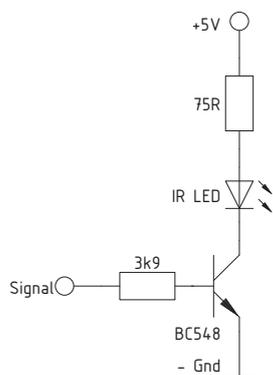

Obrázek 5.1. Příklad na 50mA IR ovladač s (V_f 1.5V, I_f 100mA,)

Poznámka: Pokud se načasování pulsů/pauzy nehodí, použij alternativu metody čekající smyčky `SW_IR_TX_ALTDELAY`.

To je nutné, pokud tvůj C kompilátor, přesto že je nastaven na zachování kódu vloženého v assembleru, optimalizujete.

5.1.12. Test optických spojek kontroluje optočlen a dává V_f LED, hodnotu CTR (také I_f) a t_{on} a t_{off} časy (pro tranzistorové typy).

Podporovány jsou standardní NPN tranzistory, NPN Darlington fáze a TRIAC. Pro CTR měření je MCU I/O pin, po dobu přibližně 3 ms, krátce přetížen.

Datový list udává maximální výstupní proud 20 mA, pin je ale přetížen asi až na 100 mA. Proto je maximální hodnota CTR omezená a hodnoty nad 2000 % by měly být zpracovány s opatrností.

Maximální proud pro LED je 5 mA, což by mělo být zvažováno u typů TRIAC. Typy relé (MOSFET zády k sobě) jsou rozpoznány jako tranzistor a Hodnota CTR pak nemá smysl. Typy s antiparalelními LED budou ignorovány.

K testování potřebujete jednoduchý adaptér s následujícími třemi testovacími body: typu tranzistoru:

- anoda LED
- Katoda LED a emitoru propojená tranzistorem
- Sběratel z tranzistoru

typu TRIAC:

- anoda LED
- Katoda LED a MT1 připojená pomocí TRIAC
- MT1 od TRIAC

Adaptér můžete libovolně spojit se třemi testovacími piny testeru.

Tester pak automaticky najde přiřazení pinů.

Po spuštění připoj adaptér k testovacím pinům a krátce stiskni tlačítko.

Pokud byla opto-spojka nalezena, zobrazí tester typ a různé informace.

Pokud ji nenajde, zobrazí se na displeji „žádný“.

Blikající kurzor označuje, že se při příštím testu očekává stisknutí tlačítka.

Dvě krátké stisknutí ukončí jako obvykle test.

5.1.13. Test servopohonů pro modely Tato funkce generuje PWM signál pro serva pro výrobu modelů, která jsou ovládána s PWM 1–2 ms dlouhými pulsy.

Podporovány jsou typické PWM frekvence 50, 125, 250 a 333 Hz, s nastavitelnou délkou pulsu od 0,5 až do 2,5 ms.

Kromě toho existuje režim rozmítání pro impulzy 1 - 2ms s volitelnou rychlostí.

Šířku pulzu nastavíš pomocí otočného kodéru. Doleva pro kratší pulsy, doprava pro delší.

Dlouhým stisknutím tlačítka se šířka pulzu nastaví na (střední polohu serva), to je na 1,5 ms. Krátkým stiskem tlačítka přepínáš mezi výběrem pulzu a frekvencí. (označené hvězdičkou).

Ve volbě frekvence přepínáš rotačním kodérem mezi kmitočty. Dlouhé stisknutí zapne nebo vypne „Sweep-mod“ (označený „<->“). Pokud je „Sweep-mod“ zapnutý, je délka impulsu nahrazena „Sweep“ časem, který lze změnit pomocí otočného kodéru. Funkci jako obvykle zastaví dvojitý stisk tlačítka.

Rozložení testovacích pinů:

- Pin # 2: PWM výstup (přes 680 Ω odpor k omezení proudu)
- Pin # 1 a # 3: uzemněny

Poznámka: Servo potřebuje svoje napájení.

Výrobce	Pin 1	Pin 2	Pin 3
Airtronics	PWM bílá/černá	Gnd černá	Vcc červená
Futaba	PWM bílá	Vcc červená	Gnd černá
hitec	PWM žlutá	Vcc červená	Gnd černá
JR Radios	PWM Oranžová	Vcc červená	Gnd hnědá

Tabulka 5.1. Rozložení pinů pro typické 3kolíkové servopohony

5.1.14. Snímač teploty DS18B20 v tomto výběru lze použít tento teplotní OneWire senzor ke čtení teplot.

K nastavení OneWire sběrnice na stránce 25, viz část „Busse“. Při použití testovacích pinů tester informuje o zapojení a čeká dokud není detekován externí pull-up odpor. To lze přeskočit stisknutím tlačítka. Po připojení DS18B20, vyzve tester k zmáčknutí tlačítka. Nápisem „start“, se stisknutím tlačítka začne číst teplota (která může trvat téměř sekundu). Nezapomeň připnout paralelně k senzoru mezi TP2 (+) a TP3 (in) odpor s 4k7 Ω .

Pro ukončení stiskni krátce dvakrát testovací tlačítko.

5.1.15. Autotest Pokud jsi autotest spustil pomocí nabídky, vyzve tě tester ke zkratování zkušebních pinů a čeká, až je rozpozná.

V případě problémů můžeš čekání stiskem klávesy přerušit. Autotest provádí každý test 5krát.

Krátké stisknutí tlačítka přeskočí aktuální test a dlouhý stisk tlačítka kompletní test. V testu # 4 musí být zkrat odstraněn. Tester v tomto kroku tak dlouho čeká.

Kroky testu jsou:

- interní referenční napětí T1 (v mV)
- T2 Srovnání odporů Rl (offset v mV)
- T3 Srovnání Rh odporů (offset v mV)
- T4 Odstraňte zkrat zkušebních pinů/kabelu
- Test těsnosti T5 pro zkušební piny s úrovní Gnd (napětí v mV)
- Test těsnosti T6 pro zkušební piny s úrovní Vcc (napětí v mV)

5.1.16. Samočinné nastavení měří odpor a kapacitu měřicích kabelů, tzn. z desky s obvody, vnitřního zapojení a měřicího kabelu jako součet k určení nulového posunu.

Také je určen vnitřní odpor pinů MCU portů v režimu pull-up a pull-down. Pokud je srovnání přeskočeno nebo pokud jsou změřené hodnoty nepravděpodobné, převezme tester výchozí hodnoty firmwaru.

Pokud běží všechno hladce, zobrazí se nové hodnoty, ty ale **nebudou** v EEPROMu uloženy. (viz volbu „Uložit“).

Během měření kondenzátoru (při normálním vyhledávání součástí) se automaticky stane kompenzace napětí analogového komparátoru, pokud má kondenzátor hodnotu mezi 100nF a 3,3 μ F.

Kromě toho se současně měří offset vnitřní referenční hodnoty napětí. Před provedením automatického ladění bys měl min. 3krát za sebou změřit filmový kondenzátor s kapacitou mezi 100nF a 3,3 μ F, aby bylo možné, uvedenou kompenzaci určit.

První měření je obvykle příliš nízké, druhé příliš vysoké a až od třetího měření dosáhneš správnou hodnotu. To je způsobeno offsetovými kompenzacemi.

V modelech s pevným kondenzátorem pro samo-ladění, je automatické seřízení pro měření kapacity, nahrazeno vlastní funkcí, která během testu provede se vlastní nastavení.

Zde nemusíš žádný filmový kondenzátor měřit.

Pokud se kompenzace kapacity mezi páry testovacích pinů příliš liší, můžeš v config.h přepnout na testování specifických posunů pinů (CAP_MULTIOFFSET).

Samo-ladění je do značné míry autotestu provozem a obsluhou podobné.

Kroky seřízení jsou:

- kompenzace A1 pro interní referenční napětí a analogový komparátor (pouze s pevným vyrovnávacím kondenzátorem)
- A2 Odolnost zkušebních pinů/kabelů (v 10mOhm)
- A3 Odstranění zkratu zkušebních pinů/kabelů
- vnitřní odpor A4 portových pinů pro Gnd (napětí přes RiL)
- A5 vnitřní odpor pinů portu pro Vcc (napětí přes RiH)
- kapacita testovacích pinů/kabelů A6 (v pF)

Povolené maximální hodnoty:

- zkušební kolík/kabel odpor <1,50 ohmů (dva v sérii)
- Zkušební pin/kabel kapacita <100pF

Poznámka: Pokud se hodnoty odporu zkušebních kolíků příliš liší, je možný kontaktní problém.

Pamatuj: Nastavení není kalibrace!

- Kalibrace je postup pro porovnání výsledků měření se sledovatelnými standardy a odchylky zaznamenat. Účelem je sledovat a odstraňovat časové odchylky.
- Nastavení je postup nastavit měřicího zařízení tak, aby dodržovalo svou danou přesnost a další parametry.

5.1.17. Uschovat/Použít Při vypálení firmwaru se vloží sada předem definovaných výchozích hodnot do EEPROMu.

Po samo nastavení může tato funkce přepsat výchozí hodnoty správnými hodnotami.

Při příštím restartu testeru se tyto hodnoty (profil #1) automaticky načtou a použijí.

Pro usnadnění jsou k dispozici dva profily pro uložení nebo načtení, např. pro dvě různé sady měřicích kabelů.

Myšlenka funkce manuálního ukládání je taková, že když dočasně změniš měřicí kabely a provedeš samočinné nastavení, tak máš po restartu opět hodnoty pro hlavní měřicí kabely.

Jinak bys musel své standardní kabely znovu nastavit.

5.1.18. Ukázat hodnoty Tato funkce zobrazuje aktuální hodnoty nastavení.

Použití externí reference napětí 2.5V je signalizováno „*“ po Vcc.

5.1.19. Vypnout Za předpokladu, že jsi tuto funkci přes SW_POWER_OFF strana 25 aktivoval, můžeš zde tester vypnout.

5.1.20. Konec ti umožní opustit nabídku a vrátit se k měření, když jsi do ni náhodou/-nechtě vstoupil.

Jak již bylo zmíněno, firmware lze přizpůsobit pro různé testery a další funkce.

6.1. V k-verzi

ovládáš nastavením v Makefile. Proto, že projektant pro tento tester tento soubor předkonfiguroval, musíš v praxi nastavit pouze tvůj programátor a jazyk obsluhy. Ten řádek 190 jsem změnil jen proto, že je ten výstup tak jako-tak aktivovaný. Jen ten text byl utlumený. Změny pro tento tester jsou minimální:

Software	Originál KHK verze 1.13k
Jméno podadresáře	mega644_hiland_m644
použito FLASH	53.9 %
použito EEPROM	2.2 %
řádek	změna v Makefile
75	UI_LANGUAGE = LANG_CZECH
190	CFLAGS += -DFREQUENCY_50HZ
375	PROGRAMMER=usbasp
376	BitClock=20
377	PORT=usb

Tabulka 6.1. Použitá k-software a změny v Makefile

Kromě toho byly s úspěchem vyzkoušeny : POLOLU a USBtiny ISP

6.2. V m-verzi

vypadá ta situace úplně jinak. Vývojář se zcela spolehne na technické znalosti svých příznivců a jejich smysl k experimentování.

Jako pomoc slouží soubor Clones.txt ve které jsou různé kloní stručně popsané, například tento tester je tam pod jménem AY AT Clone. To byl jeden z důvodů, napsat toto příručku.

Nastavení jsou zde rozmístěny v souboru Makefile, config.h a config<MCU>.h.

- Makefile řídí překlad zdrojového kódu a obsahuje základní věci, jako jsou typy MCU a ISP programátory.

-V souboru config.h existují obecná nastavení pro provoz a funkce

a soubor config<MCU>.h je zodpovědný za věci na hardwarové úrovni, tedy za moduly LCD a přiřazení pinů.

6.3. Makefile

V Makefile se provádí nastavení nastavením určitých proměnných. K přizpůsobení změn prostě hodnotu nebo řetězec za proměnnou. Pro některé proměnné existuje několik návrhů, které jsou komentovány pomocí symbolu #. Tam, v případě potřeby komentář (# smazat) a nebo komentář k výchozímu nastavení (# vložit).

6.3.1. MCU úprava

20 MCU = atmega644

Výpis 6.1. MCU-Typ

Výpis 6.2. MCU volba pro AVRdude

6.3.2. AVRdude ISP-Programátor AVRdude potřebuje jméno programátora; bitový čas a port. Pokud není tvůj programátor uvedený, přidej ho ručně.

```

60 # avrdude: ISP programmer
61 #PROGRAMMER = buspirate
62 #PROGRAMMER = USBasp
63 #PROGRAMMER = usbtiny
64 #PROGRAMMER = stk500v2
65 PROGRAMMER = avrispmkII
66
67 # avrdude: port of ISP programmer
68 #PORT = /dev/bus_pirate
69 #PORT = /dev/ttyACM0
70 PORT = usb
71
72 # avrdude: bitclock
73 BITCLOCK = 10.0

```

Výpis 6.3. Tyto řádky musíš editovat

```

# Volba pro Buspirate
# PROGRAMMER = buspirate
# BITCLOCK=10
# PORT = /dev/bus_pirate

# Volba pro USBasp von Fischl
# PROGRAMMER = USBasp
# BITCLOCK=20
# PORT = usb

# Volba pro USBtiny ISP
# PROGRAMMER = usbtiny
# BITCLOCK=10
# PORT = usb

# Volba pro Pololu
# PROGRAMMER=stk500v2
# BITCLOCK=1.0
# PORT = /dev/ttyACM0

# Volba pro Diamex
PROGRAMMER = avrispmkII    <- aktuálně zvolený
BITCLOCK=5.0              <- aktuálně zvolený nahoře je (10)
PORT = usb                 <- aktuálně zvolený

```

Další informace najdeš v příručce AVRdude nebo v online dokumentaci [5].

6.4. config.h

Tento soubor slouží k nastavení provozu a funkcí. Protože se zde jedná o normální soubor se záhlavím C, používají se zde, na rozdíl od „Makefile“ známá pravidla komentování v C. Chceš-li něco aktivovat, odstraň znaky „//“ na začátku řádku a na deaktivování je zase na začátek řádku vlož. Některá nastavení vyžadují číselnou hodnotu, kterou můžeš případně upravit.

6.4.1. Pro tento tester musí být změněno

```
38 #define HW_ENCODER
```

Výpis 6.4. nastavení kodéru

```
48 #define ENCODER_PULSES 4
```

Výpis 6.5. počet poloh pro krok

```
60 #define ENCODER_STEPS 20
```

Výpis 6.6. počet kroků kodéru

```
82 #define HW_REF25
```

Výpis 6.7. externí reference

```
115 #define HW_ZENER
```

Výpis 6.8. aktivace voltmetru a Z-diod

```
151 #define HW_FREQ_COUNTER_EXT
```

```
152 #define FREQ_COUNTER_PRESCALER 16 /* 16:1 */
```

Výpis 6.9. aktivace čítače frekvence

```
167 #define HW_EVENT_COUNTER
```

Výpis 6.10. aktivace čítače událostí

```
188 #define HW_ADJUST_CAP
```

Výpis 6.11. aktivace vestaveného kondenzátoru pro kalibraci

```
210 //#define SW_PWM_SIMPLE
```

Výpis 6.12. deaktivace jednoduchého PWM

```
219 #define SW_PWM_PLUS
```

Výpis 6.13. aktivace rozšířeného PWM

```
227 #define SW_INDUCTOR
```

Výpis 6.14. aktivace měření cívek

```
237 #define SW_ESR
```

Výpis 6.15. aktivace měření ESR

```
246 #define SW_ENCODER
```

Výpis 6.16. aktivace měření otočných kodérů

```
255 #define SW_SQUAREWAVE
```

Výpis 6.17. aktivace generace signálů

```
265 #define SW_IR_RECEIVER
```

Výpis 6.18. deaktivace IR přijímače (schází modul)

```
321 #define SW_OPTO_COUPLER
```

Výpis 6.19. aktivace měření optonu

```
329 #define SW_UJT
```

Výpis 6.20. aktivace měření SW_UJT

```
339 #define SW_SERVO
```

Výpis 6.21. aktivace testování modelových servos

```
348 #define SW_DS18B20
```

Výpis 6.22. aktivace měření teploty

```
357 #define SW_CAP_LEAKAGE
```

Výpis 6.23. aktivace měření úniku u elkos

```
406 ///#define UI_ENGLISH
```

```
407 #define UI_CZECH
```

```
408 ///#define UI_DANISH
```

```
409 ///#define UI_GERMAN
```

Výpis 6.24. deaktivace angličtiny a aktivace češtiny

```
421 #define UI_COMMA
```

Výpis 6.25. používání čárky místo tečky

```
438 #define UI_AUTOHOLD
```

Výpis 6.26. aktivace jednotlivého měření

```
458 #define UI_KEY_HINTS
```

Výpis 6.27. aktivace pomoci pro menu

```
504 #define POWER_OFF_TIMEOUT 30
```

Výpis 6.28. automatické vypínání za 30 vteřin

```
514 ///#define SW_PROBE_COLORS
```

Výpis 6.29. deaktivace barevného označení pinů

```
522 #define SW_POWER_OFF
```

Výpis 6.30. aktivace nabídky vypnutí v menu

```
810 #define ONEWIRE_PROBES /* via probes */
```

Výpis 6.31. Aktivace OneWire Rozhraní, pro DS18B20

6.5. Config_644.h

obsahuje nastavení na hardwarově blízké úrovni pro displeje, ovládání a tak dále. Protože přiřazení pinů závisí na MCU typu, existují pro ATmega328 a rodinu kolem ATmega644 vlastní soubory s příslušným standardním přiřazením. Při překladu firmware je podle v Makefile zvoleným MCU, automaticky integrován vhodný soubor. Zde se také jedná o soubor se záhlavím C, tzn. platí zde stejná pravidla komentování jako v config.h. Kromě “//” pro jednotlivé řádky, se pro blokové komentáře používají “#if 0 ... #endif”. tzn. na začátek vložit “#if 0” a na konec “#endif”. K použití kódu jednoduše řádky s “#if 0” a “#endif” odstranit. Místo odstranění stačí vložit před “#if 0” a před “#endif” “//”.

6.5.1. Nutné změny

```
98 // #if 0
99 #define LCD_ST7565R          /* display controller ST7565R */
100 #define LCD_GRAPHIC        /* graphic display */
101 #define LCD_SPI            /* SPI interface */
102 #define LCD_PORT          PORTB /* port data register */
103 #define LCD_DDR           DDRB  /* port data direction register */
104 #define LCD_RESET         PB4  /* port pin used for /RES (optional) */
105 // #define LCD_CS          PB2  /* port pin used for /CS1 (optional) */
106 #define LCD_A0            PB5  /* port pin used for A0 */
107 #define LCD_SCL           PB6  /* port pin used for SCL */
108 #define LCD_SI            PB7  /* port pin used for SI (LCD's data input) */
109 #define LCD_DOTS_X        128 /* number of horizontal dots */
110 #define LCD_DOTS_Y        64  /* number of vertical dots */
111 // #define LCD_FLIP_X      /* enable horizontal flip */
112 // #define LCD_OFFSET_X   /* enable x offset of 4 dots */
113 #define LCD_FLIP_Y        /* enable vertical flip */
114 #define LCD_START_Y       0    /* start line (0-63) */
115 #define LCD_CONTRAST      3    /* default contrast (0-63) */
116 #define FONT_6X8_VF       /* 6x8 font, vertically aligned & flipped */
117 // #define FONT_8X8_VF    /* 8x8 font, vertically aligned & flipped */
118 // #define FONT_8X16_VFP /* 8x16 font, vertically aligned & flipped */
119 // #define FONT_8X8_CYRILLIC_VF /* 8x8 cyrillic font, vertically aligned & flipped */
120 // #define FONT_8X16_CYRILLIC_VFP /* 8x16 cyrillic font, vertically aligned & flipped */
121 #define SYMBOLS_24X24_VFP /* 24x24 symbols, vertically aligned & flipped */
122 // #define SPI_HARDWARE   /* hardware SPI */
123 #define SPI_BITBANG        /* bit-bang SPI */
124 #define SPI_PORT          LCD_PORT /* SPI port data register */
125 #define SPI_DDR           LCD_DDR  /* SPI port data direction register */
126 #define SPI_SCK           LCD_SCL  /* port pin used for SCK */
127 #define SPI_MOSI          LCD_SI   /* port pin used for MOSI */
128 // #endif
```

Výpis 6.32. Deaktivovaný LCD Modul aktivován a nastaven

```
136 * ILI9342, SPI interface (hardware)
137 */
138
139 #if 0
```

Výpis 6.33. Aktivovaný ILI9342 deaktivován

```
157 #endif
```

Výpis 6.34. Aktivovaný ILI9342 deaktivován

6.5.2. Poznámka

Toto nastavení bylo tak zvolené, aby bylo možné srovnání s k-versí.

Software	m-verse 1.37m
Jméno klone	Hiland M644
použito FLASH	52 %
použito EEPROM	49,3 %

Tabulka 6.2. Údaje pro aktivovanou m-software

Aby zůstalo všem ostatním kolegům zoufalství a „bezesné noci“, kterými trpěl autor této kapitoly poté, co získal tohoto klona a bez jakékoli zkušenosti s AVR se rozhodl, ho „naučit česky“, ušetřeno, vznikla tato kapitola. Získané zkušenosti by měly pomoci všem ostatním naivním, „ochotným . . . lehkomyšlným a nezkušeným“ . . . , ÚSPĚŠNĚ naprogramovat jejich tester.

Tato příležitost je zároveň využita, poděkovat autorovi a vývojáři tranzistorového testeru Karlovi-Heinzy Kübbelerovi viz [2] za jeho obětavost a trpělivost, protože bez jeho pomoci, by následující stránky nebyly napsány.

Aby překlad firmwaru a vypálení do MCU uspělo a současně . . . „nemuselo být „kolo“ znovu objeveno“, je část následujících stránek převzatá z popisu testeru tranzistoru od Karl-Heinze Kübbelera viz [2].

Tak ještě jednou . . . **MOC VELKÝ VĚDĚK.**

7.1. Konfigurace testeru

K tomu si přečti kapitolu 6 od stránky 22. Více informací dostaneš na [2] a [4]

7.2. Programování testeru

Programování testeru je řízeno souborem Makefile. Makefile zajišťuje, že přeložená software odpovídá předem zvoleným možnostem.

Výsledkem překladu má příponu souboru .hex a .eep.

Soubory se obvykle nazývají XXXTester.hex a XXXTester.eep.

Soubor .hex obsahuje data pro programovou paměť (Flash) procesoru ATmega.

Soubor .eep obsahuje data pro EEPROM ATmega. Oba soubory musí být načteny do správného úložiště.

Navíc musí být u ATmega nakonfigurovány správně pojistky. Pokud používáš Makefile spolu s programem avrdude [5], nepotřebuješ mít žádnou přesnou znalost detailů pojistek.

Pokud si nejsi s nastavením pojistek jistý, nech je na poprvé nastavit standartě a nech tester běžet v tomto režimu. Když používáš 8MHz operační takt je možné, že program běží příliš pomalu, to ale můžeš to opravit později!

Nesprávně nastavené pojistek však mohou zabránit pozdějšímu ISP programování.

7.2.1. Operační system Linux Programování pod Linuxem přináší mnoho výhod, protože tento OS byl vyvinut odborníky, kteří se orientují přáním uživatelů.

Prostředí je navíc k dispozici zdarma a je dokonale udržováno. Další výhodou je zabezpečení samotného operačního systému, hlavně při používání internetu. Jak používání, tak i instalace dnešních vydání je mnohem jednodušší než u konkurenčních operačních systémů.

Tento tutoriál je tak navržen, aby povzbudil všechny „ne“ uživatele Linuxu, aby se o tom, naprogramováním svého testeru v Linuxu, přesvědčili.

Jako příklad, je zde použitý Linux Mint v aktuální verzi, která je bezplatně k dispozici na internetu. Instalace je možná na různé způsoby, Linux přinese svého spouštěcího asistenta, který se samostatně předchozí OS respektuje a nakonfiguruje.

7.2.2. Použití s Linuxem jako nově instalovaným operačním systémem. Pro ty, co neradi píšou, existuje v Linuxu snadný způsob si tuto práci značně ulehčit. Zaručeně si to zamiluješ.

Zkopíruj tuto příručku na USB klíčenku a otevři ji v tvém novém Linuxu.

Poté přesuň myš na název dokumentu, tj. na text (ctester.pdf), stiskni levé myší tlačítko a táhni dokument k levému okraji obrazovky, až se zobrazí možný rámeček. Nyní myš uvolni.

Příručka nyní zabere levou polovinu obrazovky.

7.2.3. Instalace programových balíčků za předpokladu, že máš připojení k internetu.

K naprogramování testeru, musíš nejprve nainstalovat programové balíčky:

```
'binutils-avr', 'avrdude', 'avr-libc' a 'gcc-avr'.
```

Toho dosáhneš jednoduše, když přejdeš na této stránce k následujícímu textu:

```
sudo apt-get install avrdude avr-libc binutils-avr gcc-avr
```

V dalším kroku se současně stiskni [Ctrl] + [Alt] + [t] k otevření příkazového okna, které již známým způsobem přesuneš, nyní na pravý okraj obrazovky. A začínáme:

Označ levým myším tlačítkem ten výše jmenovaný text v levém okně,

Přesuň myš na kurzor v pravém příkazovém okně a stiskni prostřední tlačítko myši (kolečko) **dále zkráceně [ST]**. Tím kopíruješ text mezi okny.

Po potvrzení pomocí [Enter], vyžaduje 'sudo' tvé uživatelské heslo. Na rozdíl od Windows se zde heslo zadává **po slepu** a potvrzuje se klávesou [Enter].

Tím se automaticky nainstalují všechny potřebné softwarové balíčky.

Eventuálně musíš mezitím potvrdit možnou otázku pomocí [J].

Zapamatuj si, že Linux vždy rozlišuje mezi malými a velkými písmeny.

Takže neodpovídej s [j], ale s [J]!

7.2.4. Stáhnutí zdrojů softwaru a dokumentace, potřebuješ balíček 'subversion'.

Toho dosáhneš pomocí prohlášení:

```
sudo apt install subversion
```

a po instalaci balíčku s:

```
svn checkout svn://www.mikrocontroller.net/transistortester
```

Pokud jsi tento archiv již stáhnul, stáhneš tímto příkazem pouze nové aktualizace.

Soubory jsou nyní v Linuxu [Osobní složka] na (/home/„user“) pod názvem „transistortester“.

Kontrola přítomnosti. Otevři okno terminálu, zadej „ls“ a potvrď.

7.2.5. Používání rozhraní ... připravit uživatele (user).

USB zařízení lze zjistit zadáním 'lsusb' v příkazovém okně. Zadej 'lsusb' nejprve bez a potom s připojeným USB programátorem.

Porovnáním výsledků najdeš tvůj USB programátor.

Výsledek lsusb může vypadat takto:

```
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 003: ID 046d:c050 Logitech, Inc. RX 250 Optical Mouse
Bus 002 Device 058: ID 03eb:2104 Atmel Corp. AVR ISP mkII
Bus 002 Device 059: ID 2341:0042 Arduino SA Mega 2560 R3 (CDC ACM)
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub}
```

Zde byl detekován jako zařízení 58 AVR ISP mkII (DIAMEX ALL-AVR). ID 03eb je ID výrobce a ID 2104 je ID produktu.

Tyto dva identifikátory jsou potřebné na zapsání v souboru /etc/udev/rules.d/90-atmel.rules zadáním:

```
sudo xed /etc/udev/rules.d/90-atmel.rules
```

V tomto příkladu se soubor 90-atmel.rules skládá z jednoho řádku:

```
SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="03eb", ATTRS{idProduct}=="2104", MODE="0660",
GROUP="plugdev"
```

Tato položka umožňuje přístup k zařízení pro členy skupiny 'plugdev'.

Chceš-li použít většinu programátorů, doporučuje se v 90-atmel.rules následující text:

```
# Copy this file to /etc/udev/rules.d/90-atmel.rules
# AVR ISP mkII - DIAMEX ALL-AVR
SUBSYSTEM=="usb", ATTRS {idVendor}=="03eb", ATTS {idProduct}=="2104", MODE="0660",
GROUP = "plugdev",
# USB ISP-programmer für Atmel AVR
SUBSYSTEM=="usb", ENV {DEVTYPE}=="usb_device", SYSFS {idVendor}=="16c0", MODE="0666",
SYSFS {idProduct} == "05dc",
# USB asp programmer
ATTRS {idVendor}=="16c0", ATTRS {idProduct}=="05dc", GROUP="plugdev", MODE="0660"
# USBtiny programmer
ATTRS {idVendor}=="1781", ATTRS {idProduct}=="0c9f", GROUP="plugdev", MODE="0660"
# Pololu programmer
SUBSYSTEM=="usb", ATTRS {idVendor}=="1ff8", MODE="0666"
```

Po vytvoření souboru lze tvorbu a obsah kontrolovat pomocí:

```
less /etc/udev/rules.d/90-atmel.rules
```

Systém USB zařízení Arduino SA Mega 2560, s 'lsusb' známý jako Device 59, generuje přístup k sériovému zařízení „/dev/ttyACM0“ pro členy skupiny „dialout“.

7.2.6. Členství ve skupině pro tvé vlastní uživatelské jméno, ve skupinách 'plugdev' i 'dialout' dosáhneš příkazem:

```
sudo usermod -a -G dialout,plugdev $USER
```

Nyní by měl být možný přístup s avrdude k objem zařízení. Můžeš to kontrolovat příkazem: 'id'. Pokud by se vyskytly problémy, můžeš také přistoupit k členství prostřednictvím:

Nabídka menu/Správa systému/Uživatelé a skupiny/<Password>/ zobrazí se okno se dvěma záložkami.

Pokud nyní klikneš na své jméno na kartě uživatelé, uvidíš svůj profil a skupinové přidružení na pravé straně. Pomocí tlačítka <ADD> je nyní možné, přidat nové skupiny.

7.2.7. Příprava pracovního prostředí byla zvolena při instalování m-verse.

Nejdříve naviguj v systémové liště se zelenou ikonou složky do /transistortester/Software/Markus/.

Jako druhé klikni pravým tlačítkem na nejaktuálnější ComponentTester-1.xxm.tgz a ve výběru <rozbalte zde> složku dekomprimuj.

Aby se zachoval originál a protože se terminálové okno vždy otevírá v ../home/"user", nabízí se tam přesunout svůj pracovní adresář s názvem **Mytester**.

Za třetí označ následující adresář, již známou metodou, a vlož do okna terminálu s [ST]:

```
cd transistortester/Software/Markus/
```

Po potvrzení se zobrazí všechny složky s příponou.tgz, pouze u jedné složky tato přípona chybí -> naše (právě rozbalená) složka.

Pro následující dva příkazy nejprve **JEN** vlož do terminálového okna **bez** stisknutí [Enter]!:

```
cp -r 'MyT' Mytester/
```

Označ myší ten nahoře právě rozbalený adresář.

Nyní umísti, pomocí [levé šipky] klávesnice, blikající kurzor za poslední znak textu „MyT“ a tyto znaky vymaž. Po odstranění posledního znaku stiskni [ST] na myši. Teprve nyní použij [Enter]. Tím jsi vytvořil pracovní prostředí. Kontrola existence a obsahu je možná pomocí:

```
diff 'MyT' Mytester/
```

také zde musí být „MyT“ nahrazeno jménem „požadovaného modelu testeru“. S posledním výrokem:

```
ln -s ~/transistortester/Software//Markus/Mytester ~/Mytester
```

vytvoříš odkaz na pracovní adresář.

Od této chvíle se dostaneš lehce do tohoto adresáře pomocí:

```
[Strg] + [Alt] + [t], cd [Leertaste] My [Tab] [Enter]
```

a jseš v požadovaném adresáři. S 'ls' můžeš vidět jeho obsah.

Nyní pokračuj v úpravách Makefile pomocí již známého příkazu:

```
xed Ma [Tab] [Enter]
```

Zde je nejdůležitější přihlásit svůj EXISTUJÍCÍ USB Programátor.

Viz k tomu v kapitole 6.3.2, na straně 23, téma PROGRAMMER.

Následující možnosti jsou:

make clean	k vyčištění pracovního prostředí
make	k přeložení programu
make upload	k načtení programu přes ISP rozhraní do ATmega

Nyní zbývá jen radost po dosaženém úspěchu.

7.2.8. U k-verze se nabízí, vytvořit nový dokument a do něj aktuální cestu jednoduše z okna terminálu zkopírovat. Kromě toho do něj můžeš napsat svoje používané příkazy, které máš pak lehce u ruky. Ten postup je následující, zmáčkni [Strg] + [Alt] + [t] a zkopíruj do něj následující povel:

```
xed k-verze.txt [Enter]
```

a nový dokument je otevřený. Do něj zkopíruj následující řádky:

```
cd transistortester/Software/trunk/mega644_hiland_m644/ - Dále tam napiš další tvoje poznámky. Nyní ho musíš jen pod pracovní plochou uložit.
```

7.3. Hardware k programování


Pro úplné začátečníky, kteří ještě nic nemají následující informace.

7.3.1. Programátor nepotřebuje v Linuxu ovladač. Jen ho musíš podle části 7.2.5 přihlásit a v Makefile 6.3.2 správně nastavit.

Výhodou 'avrdude' je, že se spokojí i s lacinými programátory, které koupíš již za 2 Euro na příklad dole na této stránce 7.3.2. Dále je třeba upravit svůj programovací kabel, který lze relativně lehce vyrobit. Při dodání je testovací zásuvka volně přiložena.

Na desce jsou zdířky, přes které lze sokl připojit, což není v praxi optimální. Viz pravý obrázek 2.1 na stránce 5. Na levém obrázku je ta zásuvka přímo naletována, a ty tímto ušetřené kontakty byly naletovány na vlastní (zkrácený) kabel a zajištěny smršťovací hadicí.

POZOR při použití letovací pasty, ta je vodivá a její zbytky můžou výsledky měření znehodnotit.

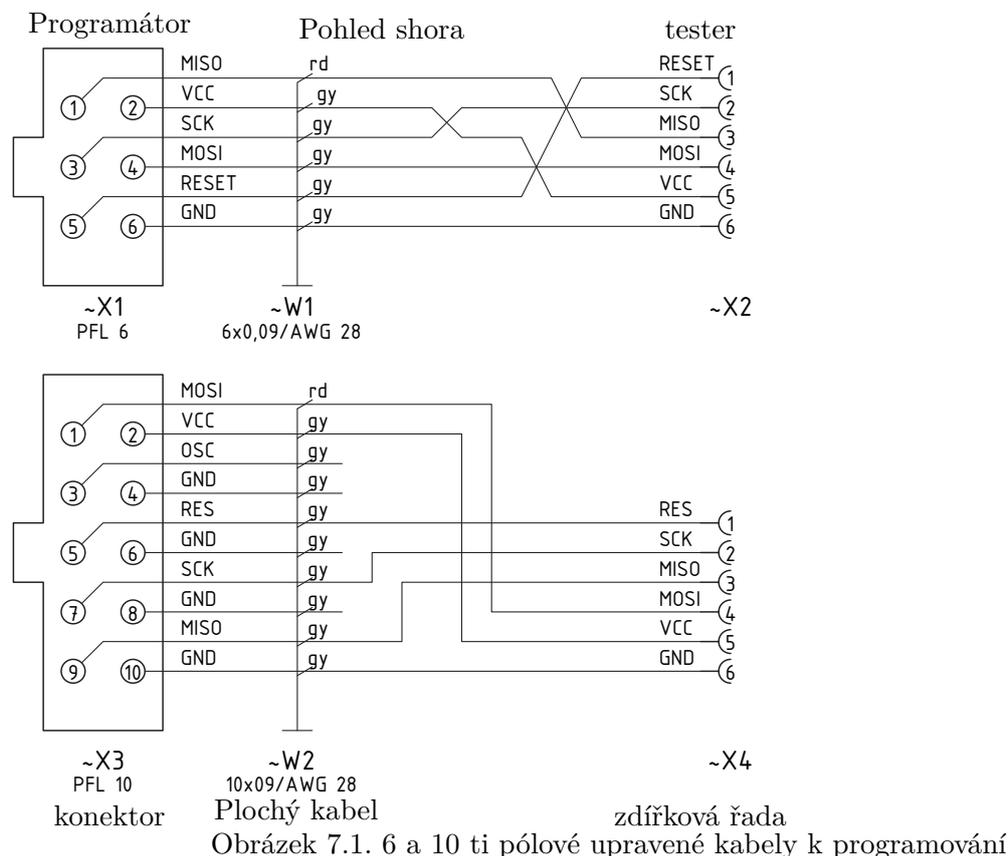

Obrázek 7.1. 6 a 10 ti pólové upravené kabely k programování

Více není zapotřebí. ;-)

7.3.2. Možnost ke koupi:

- **Programátor:** Na příklad [9].
- **A jestli ještě žádný tester nevlastníš:** na příklad [10].

7.5. Technické údaje

Model	Hiland
Velikost	75 x 63 x 35 mm
Druh součástek	SMD
AVR	ATmega 644PA
Krystal	8 MHz
Displej	ST7565-based LCD
IDE možné	ano
Ovládání	Rotační snímač s integrovaným tlačítkem
Napájení	9V blok
Spotřeba v provozu	
Spotřeba standby	20 nA
Měřicí napětí	5V
Měřicí proud	6 mA
Určení a měření	Tranzistory, MOSFET, JFET, P-IGBT, diody, Tyristory a triaky
Určení a měření	Zenerovy diody do 50V
Určení a měření	Odpory, Kondenzátory, cívky, Krystaly
Měření frekvence	1 Hz -
Generování frekvence	1 Hz - 2MHz
Generování impulsů	Při 8MHz taktu = frekvence 7,8 kHz. Impuls 1% - 99%
Měření napětí	0V - 50 V
Rozsah odpory	0,01 -
Rozsah kondenzátory	1pF - 100mF
Rozsah cívky	0,01mH -

Tabulka 7.1. Technické údaje

7.6. Pomoc

můžeš dostat v německém fórum [6].

Anglické fórum dosáhneš na [7]

a slovenské na [8].

A pro chvílku oddechu nebo pro zaměstnání potomstva: [11].

Literatura

- [1] <http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Transistortester>
Online Dokumentation des Transistortesters, Online Article, 2009-2011
- [2] <https://github.com/svn2github/transistortester/blob/master/Doku/trunk/pdftex/german/ttester.pdf>
Aktuální návod k Transistor Testeru
- [3] <https://www.mikrocontroller.net/svnbrowser/transistortester/Software/Markus>
Kompletní Software Sbíрка 2012-2019
- [4] <https://github.com/madires/Transistortester-Warehouse>
Kompletní Software Sbíрка 2012-2019
- [5] <http://www.mikrocontroller.net/articles/AVRDUDE>
Online Dokumentace avrdude IDE
Online Dokument, 2004-2011
- [6] <https://www.mikrocontroller.net/topic/248078>
Hlavní řeč je němčina ale angličtina je také ok.
- [7] [https://www.eevblog.com/forum/testgear/\(dolarováznačka\)20-lcr-esr-transistor-checker-project/](https://www.eevblog.com/forum/testgear/(dolarováznačka)20-lcr-esr-transistor-checker-project/)
Jen anglicky.
- [8] <https://svetelektro.com/> *Všetko zo sveta elektroniky*
Sme najnavštevovanejší portál zo zameraním na elektroniku na Slovensku! od 2006
- [9] <https://www.ebay.de/itm/usbasp-avrisp-usbisp-Programmer-usb-10Pin-Convert-to-6P-Adapter-Board-STK50-AHS/302923364644>
Programmer.
- [10] https://de.aliexpress.com/item/4000069589587.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.66a4765cMURvYc&algo_pvid=358c0b5a-f7af-4ed8-87a8-abca3853a413&algo_expid=358c0b5a-f7af-4ed8-87a8-abca3853a413-8&btsid=6a3a33fd-563b-4c78-aa04-bfb0feda98e7&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2,searchweb201603_53
Hiland644 Tester
- [11] <https://dragoosemchama.com/en/2017/01/rex/>
Hra Tetris pro tester a další informace